Clipanlegezange 10mm

Clipanlegezange 10mm

Artikelnummern:

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Entscheidung über die Eignung des Medizinproduktes für die vorgesehene Anwendung liegt beim Verbraucher, wir übernehmen keine Haftung für Folgen von falscher Anwendung und Aufbereitung.

Funktionsprüfung

- Es ist sehr wichtig, jedes chirurgische Instrument vor jeden Gebrauch auf Brüche, Risse, oder Fehlfunktion zu prüfen. Vor allem Bereiche wie Schneiden, Spitzen, Schlüsse, Sperren, sind sorgfältig zu prüfen.

- Benutzen Sie keine beschädigten Instrumente!

- Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch. Service und Reparatur sollten nur durch entsprechend trainierte und qualifizierte Personen durchgeführt werden. Wenden Sie sich mit diesbezüglichen Fragen an den Hersteller oder Ihre medizintechnische Abteilung.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam und vollständig durch. Unsachgemäße Handhabung und Pflege, sowie zweckentfremdeter Gebrauch können zu vorzeitigem Verschleiß von chirurgischen Instrumenten führen. Personen, die diese Instrumente verwenden, sollten Kenntnisse im Einsatz und der Handhabung chirurgischer Instrumente, Zubehör und zugehöriger Geräte haben.

Ingebrauchnahme neuer Instrument

- Alle Instrumente müssen vor Ingebrauchnahme gereinigt und sterilisiert werden. Clipanlegezangen wurden für die Sterilisation im Autoklav entwickelt und haben sich für diese Art der Sterilisation bewährt. Ebenso angewandt werden können die neuen Niedrigtemperaturmethoden wie z.B. STERRAD.

Handhabung / Sicherheitshinweise

- Alle chirurgischen Instrumente sollten beim Transportieren, Reinigen, Pflegen, Sterilisieren und Lagern stets mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dies gilt insbesondere für Schneiden und feine Spitzen, welches sehr empfindliche Bereiche sind.

Montage / Demontage



1. Griff und Schaft entkuppeln und



3.Innenteil herausschrauben



2. Schaft aus der Kupplung lösen herausziehen



4. Innenteil aus dem Schaft herausziehen

Detailansicht Maulteil

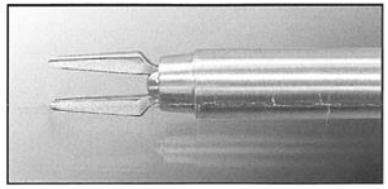

Maulteil geöffnet

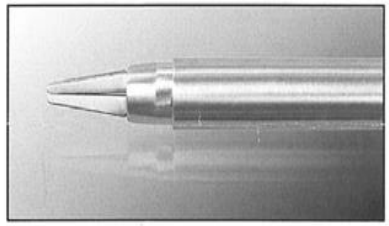

Maulteil geschlossen

Aufbereitung

⚠ **Hinweis:**	Bitte beachten Sie unsere allgemeine Aufbereitungsanweisung A0462 für wiederverwendbare endoskopische Instrumente (thermostabil). Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, fordern Sie diese bitte bei uns an.

- Jedes chirurgische Instrument sollte unmittelbar nach jedem Gebrauch desinfiziert und gründlich gereinigt werden. Reinigen, überprüfen und testen Sie jedes Instrument gründlich. Sterilisieren Sie alle Instrumente vor Gebrauch. Ein geeignetes Reinigungs- und Wartungsverfahren erhöht die Lebensdauer der Instrumente. Geachtet werden sollte dabei insbesondere auf Schlitze, Sperren, Schlüsse, Rohre und andere schwer zugängliche Bereiche. Endoskopische Clipanlegezangen sollten in zerlegten Zustand gereinigt werden (siehe Montage / Demontage). Clipanlegezangen für die offene Chirurgie sollten völlig geöffnet werden (Aushängen der Feder/ vollständiges Öffnen der Ringe).

- **Achtung**:
  - Benutzen Sie keine ätzenden oder kratzenden Reinigungsmittel (nur weiche Borsten). Mittel mit neutralem pH-Wert (7,0) sind am besten geeignet.
  - Das Instrument ist geeignet für die Ultraschallreinigung
  - Sorgfältig mit destilliertem Wasser
  - Angemessen lagern oder sterilisieren

- Nach Reinigung und Spülung des Instruments muss dieses sorgfältig getrocknet werden. Rohre müssen ausgeblasen werden.

- Standard-Sterilisationsmethoden
  - Es wird empfohlen, die Instrumente im Autoklav zu sterilisieren.
  - Sterilisieren Sie nicht in Heißluft.
  - Autoklav-Standardzyklus: Dampfsterilisation bei 134°C/ 243°F für 15 min. Andere Zeiten bzw. Temperaturen können ebenfalls eingesetzt werden. Sie sollten jedoch Abweichungen von den empfohlenen Werten zunächst validieren. (Hinweis: Lassen Sie sich durch den Hersteller Ihres Autoklaven entsprechende Temperaturen bzw. Sterilisationszeiten bestätigen). Die Temperaturen im Autoklav sollten 137°C/ 280°F nicht übersteigen.

Clipanlegezange 10mm

Zubehör und Ersatzteile

LP371-200	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Edelstahl; Kennfarbe: blau; Clipgröße: klein; Verpackungseinheit: 36 Magazine mit 6 Clips
LP371-201	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Edelstahl; Kennfarbe: weiß; Clipgröße: mittel; Verpackungseinheit: 36 Magazine mit 6 Clips
LP371-202	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Edelstahl; Kennfarb: grün; Clipgröße: mittelgroß; Verpackungseinheit: 18 Magazine mit 6 Clips
LP371-203	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Edelstahl; Kennfarbe: gelb; Clipgröße: groß; Verpackungseinheit: 18 Magazine mit 6 Clips
LP371-210	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarbe: blau; Clipgröße: klein; Verpackungseinheit: 36 Magazine mit 6 Clips
LP371-211	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarbe: blau; Clipgröße: klein; Verpackungseinheit: 15 Magazine mit 20 Clips
LP371-212	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarbe: weiß; Clipgröße: mittel; Verpackungseinheit: 36 Magazine mit 6 Clips
LP371-213	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarbe: weiß; Clipgröße: mittel; Verpackungseinheit: 15 Magazine mit 20 Clips
LP371-214	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarb: grün; Clipgröße: mittelgroß; Verpackungseinheit: 18 Magazine mit 6 Clips
LP371-215	Ethic. Ligaturclip für Clip-Anlegezange Titan; Kennfarbe: gelb; Clipgröße: groß; Verpackungseinheit: 18 Magazine mit 6 Clips

Reparatur

- Medizinprodukte unterliegen auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, je nach Anwendungsintensität, einem mehr oder weniger starken Verschleiß. Der Verschleiß ist technisch bedingt und unvermeidlich.
- Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch. Service und Reparaturen dürfen nur durch uns als Hersteller oder von uns autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Medizinprodukte, die zur Reparatur eingeschickt werden, müssen vorher gereinigt, desinfiziert und sterilisiert sein.

Bildzeichen und Erklärungen

	Gebrauchsanweisung beachten
REF	Bestellnummer
	Unsteril
	Hersteller
	Kennzeichnet eine mögliche Gefahr für Personen
	Lot-Nummer
	CE Kennzeichen

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com